



*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 158/2017/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa fabrycznie nowych modeli anatomicznych do Katedry Patofizjologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1. Dotyczy Części nr 2:

Czy Zamawiający dopuści składania w części nr 2 na pojedyncze pozycje modeli?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wymaga złożenia oferty na wszystkie pozycje w zakresie danej części postępowania.

Pytanie nr 2. Dotyczy SIWZ:

Zamawiający podając termin dostawy w dniach miał na myśli dni robocze czy kalendarzowe?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż termin wykonania zamówienia został określony w dniach kalendarzowych.

Pytanie nr 3. Dotyczy SIWZ:

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy modeli ze względu że nie jesteśmy bezpośrednim producentem a termin dostaw na dzień otrzymania wiadomości o wygranej części może ulec zmianie. Proponujemy termin dostarczenia towaru do 5 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wydłuża termin wykonania zamówienia do maksymalnie 56 dni od dnia zawarcia umowy.

W związku z powyższym, zmienia się brzmienie:

1. Rozdziału IV pkt. 1 SIWZ:

„Termin wykonania niniejszego zamówienia: w terminie maksymalnie 18 dni od dnia zawarcia umowy.”

który otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania niniejszego zamówienia: w terminie maksymalnie 56 dni od dnia zawarcia umowy.”

2. Rozdziału XIII pkt. 2 SIWZ w zakresie kryterium „Termin dostawy”:

„Wykonawcy, którzy zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, są w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie krótszym niż 18 dni, mogą zaproponować następujące terminy dostawy, którym Zamawiający przyporządkował odpowiednią punktację w ramach kryterium 40% Termin dostawy:

14 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt.;

16 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt.;

18 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt.”.

który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawcy, którzy zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, są w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie krótszym niż 56 dni, mogą zaproponować następujące terminy dostawy, którym Zamawiający przyporządkował odpowiednią punktację w ramach kryterium 40% Termin dostawy:

42 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt.;

49 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt.;

56 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt.”.

Pytanie nr 4. Dotyczy Części nr 1:

Czy Zamawiający dopuści model spełniający określone warunki natomiast bez podstawy?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż w zakresie Części nr 1 dopuszcza zaoferowanie modelu bez podstawy spełniającego pozostałe wymagania.

Pytanie nr 5. Dotyczy Części nr 2 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści model żeńskich narządów płciowych składających się z 3 bądź 4 części?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż w zakresie Części nr 2 poz. 4 wymaga zaoferowania modelu opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 6. Dotyczy Części nr 2 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści model Czaszki dydaktycznej składającej się z 22 części posiadający określone funkcje natomiast występujący pod inną nazwą?

Odpowiedź:


Zamawiający uprzejmie informuje, iż w zakresie Części nr 2 poz. 7 dopuszcza zaoferowanie modelu pod inną nazwą spełniającego wszystkie opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ wymagania.

Pytanie nr 7. Dotyczy Części nr 2 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści inny model piersi niż określił w formularzu. Wykonawca próbował znaleźć model prawej piersi u konkurencji o podanych parametrach natomiast nie udało się.

Chcieliśmy zaproponować modele spełniające podobne funkcje natomiast nieco różniące się od założonych:

1. Model do nauki palpacyjnego badania piersi, trzy pojedyncze piersi na podstawie

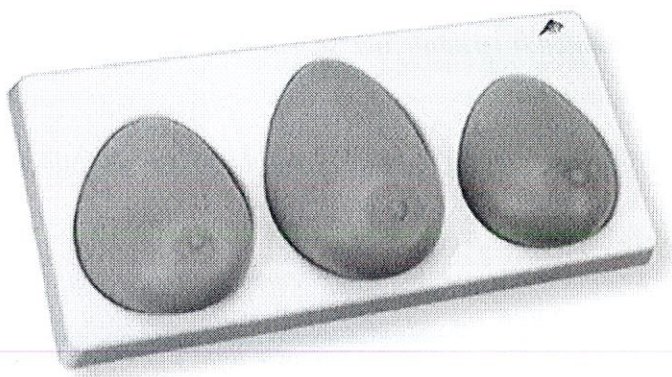


Bardzo realistyczny model trzech różnych piersi, o miseczkach C i D, do nauki badania piersi. Model zrobiony jest z silikonu, zachowuje szczegóły anatomiczne, a w dotyku łudząco przypomina skórę; w dwóch piersiach przedstawione są łagodne i złośliwe guzy w różnych stadiach, natomiast trzecia pierś jest zdrowa dla porównania.

Model dostarczany jest z podstawą i talkiem kosmetycznym.


Wymiary: 52x24.5x9.5 cm

2. Model piersi z nowotworem do nauki badania palpacyjnego

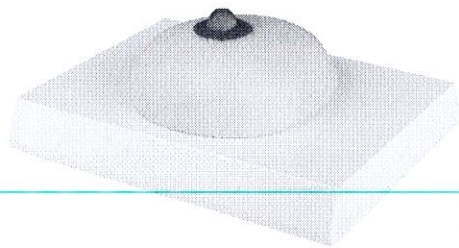

Naturalnej wielkości model żeńskiej piersi wykonany z materiału idealnie przypominającego tkankę gruczołu sutkowego. Model zawiera guzek i zmianę mastopatyczną, które można zbadać palpacyjnie. Model dostarczany wraz z kartami edukacyjnymi, które przedstawiają różne statystycznie potwierdzone położenie guzków. Dodatkowo karty edukacyjne zawierają klasyfikacje raka piersi. Model na podstawie.


3. Model lewej piersi ze zmianami skórnymi

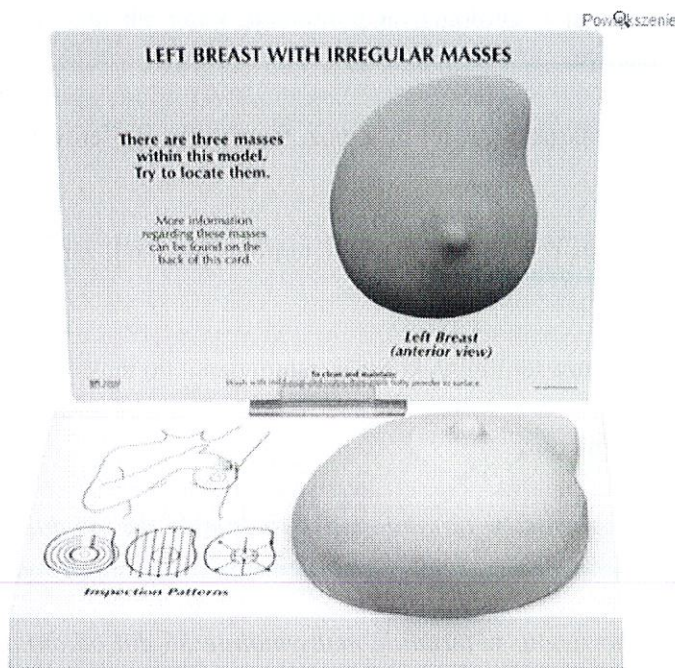

Pełny rozmiar modelu wykonany z wytrzymałego materiału z realistycznymi wyczuwalnymi grudkami, które symulują gruczołową masę, typowego guza oraz kanał mleczny. Na odwrocie karta edukacyjna.

- Wymiary : 8,75 x 6,25 x 3 cm., podstawa : 8,8 x 6,25 cm.

4. Model 2 piersi Kobiety Karmiącej i Niekarmiącej – 5 części

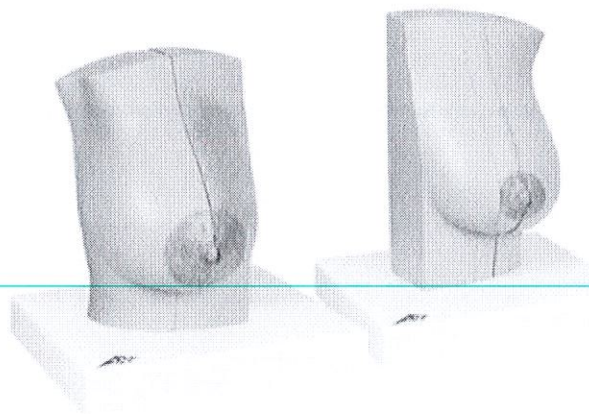

2 częściowy model piersi kobiety karmiącej:

Model zawiera dwie połowki w przekroju środkowym. Przedstawia zdrową tkankę piersi kobiety karmiącej oraz zapalenie gruczołów mlekowych.

3 częściowy model lewej piersi kobiety niekarmiącej:

Model zawiera 3 części w przekroju strzałkowym. Na zewnętrznej stronie widoczne są zdrowe struktury anatomiczne z węzłami chłonnymi. Na środkowej części przedstawiono torbiele, gruczolakowłókniaaka od strony zewnętrznej i patologiczną poliferaację komórek tkanki łącznej na wewnętrznej powierzchni oraz guzy złośliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż w zakresie Części nr 2 poz. 9 wymaga zaoferowania modelu opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 8. Dotyczy SIWZ:

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wydłuży termin wykonania zamówienia do maksymalnie 56 dni od dnia zawarcia umowy.

W związku z powyższym, zmienia się brzmienie:

1. Rozdziału IV pkt. 1 SIWZ:

„Termin wykonania niniejszego zamówienia: w terminie maksymalnie 18 dni od dnia zawarcia umowy.”

który otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania niniejszego zamówienia: w terminie maksymalnie 56 dni od dnia zawarcia umowy.”



2. Rozdziału XIII pkt. 2 SIWZ w zakresie kryterium „Termin dostawy”:

~~„Wykonawcy, którzy zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, są w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie krótszym niż 18 dni, mogą zaproponować następujące terminy dostawy, którym Zamawiający przyporządkował odpowiednią punktację w ramach kryterium 40% Termin dostawy:~~

~~14 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt.;~~

~~16 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt.;~~

~~18 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt.”.~~

~~który otrzymuje brzmienie:~~

~~„Wykonawcy, którzy zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, są w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie krótszym niż 56 dni, mogą zaproponować następujące terminy dostawy, którym Zamawiający przyporządkował odpowiednią punktację w ramach kryterium 40% Termin dostawy:~~

~~42 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt.;~~

~~49 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt.;~~

~~56 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt.”.~~

Pytanie nr 9. Dotyczy Istotnych postanowień umowy wg Załącznika nr 5 do SIWZ:

Dotyczy §6 ust. 1 b)

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 b) do 0,2%.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.

Pytanie nr 10. Dotyczy Istotnych postanowień umowy wg Załącznika nr 5 do SIWZ:

Dotyczy §6 ust. 1 c)

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 c) do 0,1%.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.

Pytanie nr 11. Dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 6 i pół miesięcy od dnia podpisania umowy w części 1 pozycji 1 oraz w części 2 pozycji 4, 5, 10 załącznika nr 1 opisu przedmiotu zamówienia?

Uzasadnienie: otrzymaliśmy potwierdzenie od producenta, że termin wyprodukowania tych modeli wynosi 6 i pół miesiąca od dnia złożenia zamówienia. Taki jest proces produkcyjny.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy w części 2 załącznika nr 1 pozostałych pozycji opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wydłuży termin wykonania zamówienia do maksymalnie 56 dni od dnia zawarcia umowy.

W związku z powyższym, zmienia się brzmienie:

1. Rozdziału IV pkt. 1 SIWZ:

„Termin wykonania niniejszego zamówienia: w terminie maksymalnie 18 dni od dnia zawarcia umowy.”

który otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania niniejszego zamówienia: w terminie maksymalnie 56 dni od dnia zawarcia umowy.”

2. Rozdziału XIII pkt. 2 SIWZ w zakresie kryterium „Termin dostawy”:



„Wykonawcy, którzy zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, są w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie krótszym niż **18 dni**, mogą zaproponować następujące terminy dostawy, którym Zamawiający przyporządkował odpowiednią punktację w ramach kryterium 40% Termin dostawy:

14 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt.;

16 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt.;

18 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt.”.

który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawcy, którzy zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, są w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie krótszym niż **56 dni**, mogą zaproponować następujące terminy dostawy, którym Zamawiający przyporządkował odpowiednią punktację w ramach kryterium 40% Termin dostawy:

42 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt.;

49 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt.;

56 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt.”.

Pytanie nr 12. Dotyczy SIWZ:

Chciałbym zapytać czy Państwo byliby zainteresowani ofertą modeli anatomicznych trójwymiarowych - wydruki anatomiczne?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wymaga zaoferowania modeli opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przy czym, zgodnie z zapisami Rozdziału III pkt. 4 Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie przedmiotów zamówienia w Załączniku nr 1 do SIWZ, o takich samych lub lepszych parametrach i właściwościach.

Z poważaniem

KANCLERZ

Załączniki:

1. Zmodyfikowany, obowiązujący Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty.

dr inż. Aleksander Socha